Asfalt Mikseri

LT-AS0008 / LT-AS0009 / LT-AS0010 | EN 12697-35

Ayarlanabilir hız • Paslanmaz kap • Opsiyonel elektrikli alt ısıtıcı



5 / 10 / 20 L

KARIŞTIRMA KAPASİTELERİ

200 °C

20 L ISITICI SEÇENEĞİNDE MAKSİMUM

Asfalt karışım tasarımı • Marshall hazırlığı • Laboratuvar kalite kontrolü

LT-AS0008 / LT-AS0009 / LT-AS0010

Fotoğraf ve Karıştırma Bileşenleri

Hız kontrolü, paslanmaz karıştırma kabı, palet ve alt ısıtıcı

Asfalt mikseri, bitüm ve agregayı laboratuvar ortamında kontrollü hızla karıştırır. Opsiyonel alt ısıtıcı, sıcak karışımın sıcaklık koşullarını korumaya yardımcı olur. Fotoğraf, ısıtıcıyla birlikte kurulu bir örneği gösterir.

HIZ KONTROLÜ

Entegre potansiyometreyle karıştırma hızını numuneye göre ayarla.

KARIŞTIRMA KABI

Paslanmaz kap, agrega ve bitümü karıştırma sırasında bir arada tutar.



KARIŞTIRMA PALETİ

Dönen palet, bağlayıcının agrega içinde dengeli dağılmasını destekler.

OPSİYONEL ISITICI

Elektrikli alt ısıtıcı, karıştırma sırasında sıcaklık kaybını azaltmaya yardımcı olur.



Zamanlayıcı, hız ayarı ve başlatma kontrolleri




Karıştırma kabı ve palet bağlantısı

LT-AS0008 / LT-AS0009 / LT-AS0010

Kontrollü Hızla Sıcak Karışım Hazırlama

Reçeteyi hazırla • Sıcaklığı düzenle • Karıştır • Numuneyi al

PALET + PASLANMAZ KAP + ISITICI SEÇENEĞİ

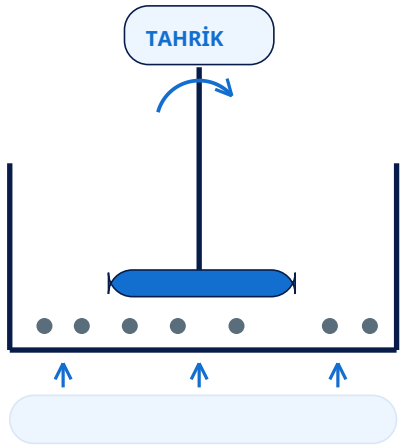

OPSİYONEL ALT ISITICI

PALET HAREKETİ AGREGA VE BİTÜMÜ KARIŞTIRIR

HIZ • SÜRE • KARIŞIM SICAKLIĞI

AGREGA + BİTÜM • KONTROLLÜ KARIŞTIRMA

Homojen laboratuvar karışımı hazırla

TEMSİLİ KARIŞTIRMA ŞEMASI • ÖLÇEKSİZ

Malzemeleri Hazırla

Reçeteye uygun agrega ve bağlayıcı miktarını hazırla. Deney sıcaklığını belirle.

Kabı Yerleştir ve Karıştır

Kabı ve paleti uygun konuma al. Numuneye uygun hız ve süreyle karıştır.

Karışımı Al ve Kaydet

Karışımı sonraki deney için al. Reçete, sıcaklık, süre ve numune kodunu kaydet.

Özel palet, agrega ve bağlayıcıyı kap içinde hareket ettirir. Hız potansiyometreyle ayarlanır; opsiyonel ısıtıcı sıcaklık kaybını sınırlamaya yardımcı olur. Karıştırma süresi, sıcaklık ve numune miktarı ilgili deney yöntemine göre seçilir.

Kapasite ve Isıtıcı Seçimi

LT-AS0008 5 L, LT-AS0009 10 L, LT-AS0010 20 L kapasite sunar. Paslanmaz kap ve palet, model kapasitesine göre seçilir.

Elektrikli alt ısıtıcı opsiyoneldir ve ayrı ürün koduyla sunulur. 20 L ısıtıcı seçeneği yaklaşık 200 °C'ye kadar çalışabilir. Diğer modeller için aynı sıcaklık sınırı varsayılmaz.

Besleme, Aksesuarlar ve Kayıt

Mikserler ve elektrikli alt ısıtıcılar 220 V, 50-60 Hz, tek faz beslemeyle çalışır. Karıştırma kabı, palet ve ısıtıcı ayrı kodlarla tedarik edilebilir.

Kap ve paleti işlem sonrasında temizle. Karışım reçetesini, sıcaklığı, süreyi ve uygulanan hız ayarını numune kaydıyla eşleştir.

LT-AS0008 / LT-AS0009 / LT-AS0010

Model ve Aksesuar Karşılaştırması

5, 10 ve 20 L modeller • Kap, palet ve opsiyonel alt ısıtıcı

Ürün Kodu	Kapasite (L)	Ölçüler (cm)	Ağırlık (kg)
LT-AS0008	5	30 × 55 × 65	55
LT-AS0009	10	70 × 75 × 80	75
LT-AS0010	20	70 × 75 × 95	110

Aksesuar Kodu	Parça	Ölçüler (cm)	Ağırlık (kg)
LT-AS0008/1	Karıştırma kabı 5 L	-	-
LT-AS0008/2	Karıştırma paleti	-	-
LT-AS0008/3	Alt ısıtıcı (ops.)	Ø25 × 30	5
LT-AS0009/1	Karıştırma kabı 10 L	-	-
LT-AS0009/2	Karıştırma paleti	-	-
LT-AS0009/3	Alt ısıtıcı (ops.)	Ø30 × 35	7
LT-AS0010/1	Karıştırma kabı 20 L	-	-
LT-AS0010/2	Karıştırma paleti	-	-
LT-AS0010/3	Alt ısıtıcı (ops.)	Ø40 × 40	10

Kap, Palet ve Isıtıcıyı Mikser Modeliyle Eşleştir

Kapasiteyi numune hacmine göre seç. /1 kap, /2 palet, /3 opsiyonel alt ısıtıcı kodudur. Sıcaklık, hız ve süreyi EN 12697-35 deney düzenine göre yönet.

Reçeteden Hazırlanmış Asfalt Numunesine

01
Hazırla
Agrega ve bağlayıcıyı reçeteye göre hazırla.

02
Ayarla
Hız, süre ve gerekli sıcaklığı ayarla.

03
Karıştır
Kabı ve paleti kullanarak karıştır.

04
Kaydet
Karışımı al ve deney koşullarını kaydet.

Ürün Sayfası | liyatest.com.tr/urun/asfalt-mikseri/