Kür Kabini

LT-CE0080 - LT-CE0084 | Sıcaklık ve nem kontrollü kür ortamı

120–1000 litre • Paslanmaz iç yapı • Dijital kontrol



20 ± 1 °C

KÜR SICAKLIĞI

>%95 BN

BAĞIL NEM

EN 196-1 • ISO 679 • Tek programlı ve 10 programlı model seçenekleri

LT-CE0080 - LT-CE0084

Fotoğraflar ve Kabin Bileşenleri

Dijital kontrol, paslanmaz raflar ve kapak bağlantısı

Kür kabini, çimento ve harç numunelerini dayanım deneylerinden önce kontrollü sıcaklık ve yüksek nem ortamında tutar. Isıtma ve soğutma sistemi sıcaklığı dengeler; bağımsız su nebülizörleri numunelerin nem kaybını sınırlar.

DİJİTAL KONTROL

Sıcaklık ve nem değerlerinin takip edildiği panel. Program seçenekleri seçilen modele bağlıdır.

PASLANMAZ İÇ YAPI

İç kabin ve raf sistemi yüksek nemli çalışma ortamına uygundur. Numuneler düzenli yerleştirilir.



KAPAK BAĞLANTISI

Kapak kolu ve kapanma düzeni. Numune yerleştirdikten sonra kapağın kapandığını kontrol et.

ALT GÖVDE

Kabin altındaki ekipman bölümü. Ön hava açıklıklarını kurulum sırasında açık bırak.



Dijital kontrol paneli ve gösterge bölgesi




Paslanmaz iç kabin ve numune rafları

Kontrollü Sıcaklık ve Nem Prensibi

Koşulları seç • Numuneleri yerleştir • Sıcaklık ve nemi izle • Kür kaydını tut

YÜKSEK NEMLİ KÜR ORTAMI • ŞEMATİK KESİT

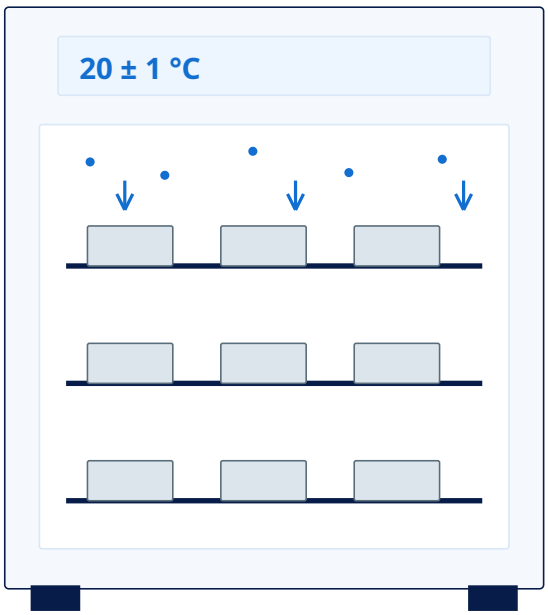

ÇİMENTO VE HARÇ NUMUNELERİNİN KÜRÜ

20 ± 1 °C | BAĞIL NEM >%95

ÇALIŞMA PRENSİBİ • ŞEMATİK GÖSTERİM • ÖLÇEKSİZ

Sıcaklığı Dengele

Isıtıcı ve soğutma ünitesi kabin sıcaklığını düzenler. Dijital panelden çalışma koşulunu izle.

Nemi Koru

Su nebülizörleri ince su zerrecikleri oluşturur. Yüksek nem, numunelerin hızlı su kaybını sınırlar.

Kür Sürecini Takip Et

Numuneleri uygun raf düzeninde yerleştir. Kür başlangıcını, koşulları ve çıkış zamanını kaydet.

Kabin, numuneleri kontrollü ve yüksek nemli bir ortamda saklar. Kullanılan deney yönteminin kür süresi ve numune hazırlama adımları korunur; numune grupları aynı koşullarda izlenir ve planlanan deney zamanında çıkarılır.

Program ve Kapasite Seçimi

120, 250, 500 ve 750 litrelik modeller, tek programlı veya adım kontrollü 10 programlı seçenekler sunar. Tek programlı sürümlerin ürün kodu /G eki taşır.

LT-CE0084, 1000 litre hacimli ve 10 programlı modeldir. Kapasiteyi kalıp boyutlarına ve günlük numune akışına göre seç; program tercihini laboratuvarın kür düzeniyle eşleştir.

Numune Yerleşimi ve Kayıt

Rafları temiz tut ve numuneleri tanımlı gruplar halinde yerleştir. Kalıpta veya kalıp dışında saklama adımını uygulanan deney yöntemine göre belirle.

Numune kimliğini, kabine giriş zamanını ve planlanan test yaşını kaydet. Kapak açılışlarını kısa tut; yerleştirme sonrasında sıcaklık ve nem değerlerini kontrol et. Su sistemini üretici bakım talimatına göre izle.

LT-CE0080 - LT-CE0084

Model Seçenekleri ve Teknik Özellikler

120, 250, 500, 750 ve 1000 litre • EN 196-1 • ISO 679

Ürün Kodu	Hacim	Kontrol Sistemi
LT-CE0080	120 L	Adım kontrollü; 10 programlı
LT-CE0080/G	120 L	Tek programlı
LT-CE0081	250 L	Adım kontrollü; 10 programlı
LT-CE0081/G	250 L	Tek programlı
LT-CE0082	500 L	Adım kontrollü; 10 programlı
LT-CE0082/G	500 L	Tek programlı
LT-CE0083	750 L	Adım kontrollü; 10 programlı
LT-CE0083/G	750 L	Tek programlı
LT-CE0084	1000 L	Adım kontrollü; 10 programlı

Ortak Özellik	Teknik Bilgi
Sıcaklık	20 ± 1 °C; ısıtma ve soğutma kontrollü
Bağıl Nem	%95 üzeri; bağımsız su nebülizörleri
İç Kabin ve Raflar	Paslanmaz çelik
Güç Kaynağı	220 V, 50–60 Hz, 1 faz
Standartlar	EN 196-1, ISO 679

Kapasite, Program ve Çalışma Koşulu

Modeli numune yüküne göre seç. Programı ve kür zamanını deney yöntemiyle eşleştir; çalışma sırasında sıcaklık ve nem değerlerini kontrol et.

Numuneden Kontrollü Kür Kaydına

01
Seç
Hacmi ve kontrol seçeneğini belirle.

02
Yerleştir
Numuneleri tanımlı raf düzeninde yerleştir.

03
İzle
Sıcaklığı, nemi ve kür süresini takip et.

04
Çıkar
Numuneleri deney zamanında çıkar ve kaydet.

Ürün Sayfası | liyatest.com.tr/urun/kur-kabini/