Vibratörlü Tokmak Seti Kango Çekici

LT-AS0111 | Düşey kılavuzlu titreşimli numune hazırlama sistemi

Bitümlü karışımlar • Uygun kalıpla Proktor ve CBR numuneleri



37 kg

TOPLAM HAREKETLİ KÜTLE

Ø102 / Ø146 mm

SIKIŞTIRMA BAŞLIĞI ÇAPLARI

Çelik kılavuz çerçeve • 300 mm aktarma mili • Değiştirilebilir başlıklar

LT-AS0111

Fotoğraf ve Sistem Bileşenleri

Elektrikli tokmak, düşey kılavuz, aktarma mili ve sıkıştırma başlığı

Vibratörlü Tokmak Seti, uygun kalıp içindeki asfalt ve zemin numunelerine titreşimli sıkıştırma uygular. Çelik çerçeve tokmak düzenini düşey yönde yönlendirir; seçilen başlık, aktarma mili üzerinden gelen titreşimi numuneye iletir.

ELEKTRİKLİ TOKMAK

Titreşim enerjisini üretir. LT-AS0111/1 tokmağın yaklaşık ağırlığı 7 kg'dır.

AKTARMA MİLİ

300 mm mil, tokmak ile seçilen sıkıştırma başlığı arasındaki bağlantıyı kurar.



KILAVUZ ÇERÇEVE

Kaplanmış çelik yapı, tokmağın ve başlığın düşey hizasını korumaya yardımcı olur.

SIKIŞTIRMA BAŞLIĞI

Ø102 ve Ø146 mm seçenekleri, farklı kalıp düzenlerine uyum sağlar.



Elektrikli tokmak ve kılavuz çerçeve bağlantısı




Sıkıştırma başlığı, kalıp ve taban düzeni

LT-AS0111

Titreşimin Numuneye Aktarılması

Kalıbı seç • Başlığı hizala • Titreşim uygula • Numuneyi hazırla

TOKMAK + AKTARMA MİLİ + SIKIŞTIRMA BAŞLIĞI

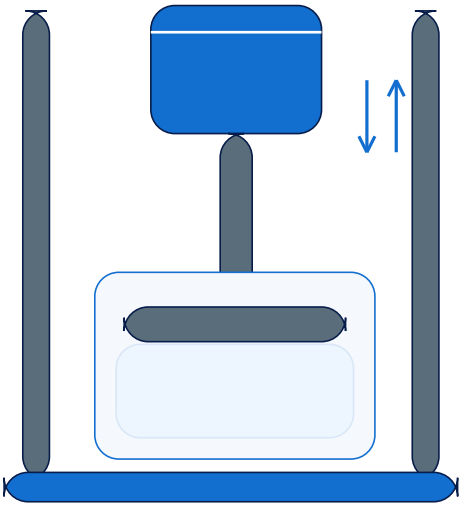

TİTREŞİM, BAŞLIK ÜZERİNDEN NUMUNEYE İLETİLİR

TOPLAM HAREKETLİ KÜTLE: 37 kg

Başlığı kalıp ve deney yöntemine göre seç

Uygun prosedürle sıkıştırılmış numune hazırla

TEMSİLİ TİTREŞİMLİ SIKIŞTIRMA KESİTİ • ÖLÇEKSİZ

Kalıbı ve Başlığı Seç

Malzemeye ve uygulanan yönteme uygun kalıp ile başlık çapını belirle.

Düşey Hizala

Kalıbı tabana yerleştir. Mil, başlık ve numune eksenini hizala.

Titreşimle Sıkıştır

Süreyi ve numune hazırlığını deney prosedürüne göre uygula; işlem kayıtlarını tut.

Elektrikli tokmak, 300 mm aktarma mili ve seçilen başlık üzerinden numuneye titreşim enerjisi uygular. Kılavuz çerçeve hareketi düşey yönde yönlendirir. Kalıp, başlık ve çalışma prosedürü hazırlanacak numuneye göre seçilir.

Bitümlü Karışım Numuneleri

Gevşek bitümlü karışımı uygun kalıba yerleştir. Başlığı numune üzerinde merkezleyerek titreşimli sıkıştırma uygula. Numune miktarı, sıcaklığı ve sıkıştırma süresini seçilen yöntemle eşleştir.

Hazırlanan numuneler, ilgili prosedüre göre yoğunluk, boşluk özellikleri veya sıkıştırılabilirlik çalışmalarında kullanılabilir. Sıkıştırma koşullarını numune kimliğiyle birlikte kaydet.

Proktor, CBR ve Aksesuar Seçimi

Sistem, uygun kalıp ve aksesuar düzeniyle Proktor ve CBR numunesi hazırlama çalışmalarını destekler. Ø102 mm küçük veya Ø146 mm geniş başlığı kalıp ölçüsüne göre seç.

P.R.D. yarıklı kalıp ve taban plakası LT-AS0111/3 koduyla listelenir. Gerekli kalıp, taban ve bağlantı parçalarını çalışma yöntemine göre ayrıca seç ve sipariş kapsamını belirle.

Teknik Özellikler ve Set Bileşenleri

LT-AS0111 | Kılavuzlu elektrikli tokmak ve iki başlık seçeneği

Parametre	Tanım / Özellik
Ana Set Ürün Kodu	LT-AS0111
Toplam Hareketli Kütle	37 kg
Küçük Sıkıştırma Başlığı	LT-AS0111/4 • Ø102 mm
Geniş Sıkıştırma Başlığı	LT-AS0111/5 • Ø146 mm
Aktarma Mili	LT-AS0111/6 • 300 mm
Ana Set Ölçüleri / Ağırlığı	51 × 30 × 112 cm / Yaklaşık 75 kg
Elektrikli Tokmak	LT-AS0111/1 • Yaklaşık 7 kg
Tokmak Ölçüleri	11 × 43 × 27 cm
Çelik Kılavuz Çerçeve	LT-AS0111/2 • Yaklaşık 45 kg
Elektrik Beslemesi	220 V • 50-60 Hz • Tek faz

Kalıp ve Başlığı Numune Hazırlama Yöntemiyle Eşleştir

Başlığın ölçü uyumunu ve düşey hizalamayı kontrol et. Malzeme, kalıp, başlık, sıkıştırma süresi ve ilgili hazırlık koşullarını birlikte kaydet.

Titreşimli Sıkıştırma İş Akışı

01
Seç
Uygun kalıp ve sıkıştırma başlığını seç.

02
Yerleştir
Malzemeyi doldur ve başlığı hizala.

03
Sıkıştır
Prosedüre uygun titreşim uygula.

04
Tamamla
Numuneyi ve işlem kayıtlarını hazırla.

Ürün Sayfası | liyatest.com.tr/urun/vibratorlu-tokmak-seti-kango-cekici/